


## Zasady doboru rozmiaru przy wymianie pierwszej Przeskórnej Endoskopowej Gastrostomii "PEG" na gastrostomię niskoprofilową "Button"



### Ogólne zasady:

- rozmiar Button taki sam jak PEG lub większy
- indywidualnie po pomiarze stomii dostosowany do pacjenta
- kanał stomii powinien być szczelnie wypełniony
- za mały rozmiar Button względem kanału stomii powoduje przeciekanie

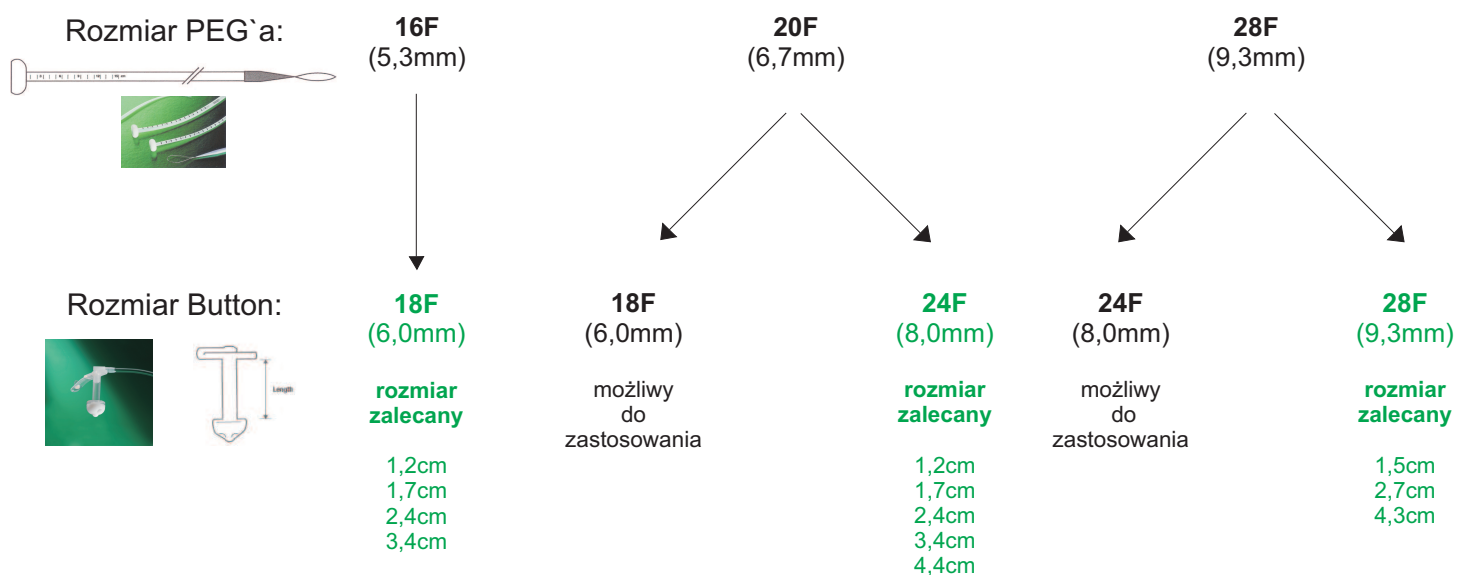